

SoloSmart

سولوسمارت لقلم سولوستار وقلم دوبلستار




دليل الاستخدام

لمساعدتك على تتبع حقن الأنسولين التي تُجرّيها

كيفية إعداد جهاز سولوسمارت الخاص بك

1 تشغيل الجهاز و شحنه


يكون الجهاز مطفأً عند شحنه. يجب عليك تشغيل الجهاز والتأكد من أنه مشحون بدرجة كافية قبل الاستخدام.



1.1 قم بتوصيل سولوسمارت بسلك اليو إس بي المزود وقم بتوصيل السلك بالشاحن الجداري يو إس بي الذي يعمل بالطاقة. سوف يشغل هذا الجهاز.



1.2 اترك الجهاز لمدة ١٠ دقائق على الأقل لكي يتم شحنه قبل الاستخدام.



1.3 افضل سولوسمارت من سلك اليو إس بي ثم افضل الشاحن الجداري. عندما تنتهي، يتحوّل ضوء إشارة سولوسمارت إلى اللون الأزرق للإشارة إلى أن الجهاز في وضع الاقتران ولكن لم يتم إقرانه بعد.

حقن جرعة وسولوسمارت معلق بقلمك

نظرة عامة

يسمح لك سولوسمارت بالحقن بواسطة قلمك كما تفعل عادة.

ارجع إلى تعليمات استخدام قلمك لاختيار السلامة (التحضير) وتعليمات الحقن.

ملاحظة: سيتم أيضًا رصد اختبارات السلامة التي يتم إجراؤها للتحقق من تدفق الأنسولين (التحضير) وتسجيلها تلقائيًا بواسطة سولوسمارت. تحقق من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك للتعرف بشكل صحيح على اختبارات السلامة التي يتم إجراؤها.

قبل الحقن بواسطة سولوسمارت



إذا أصبح الضوء أخضر ثم انطفأ، يكون سولوسمارت في الوضع النشط وجاهزًا للاستخدام للحقن.

إذا لم يشعل الضوء بعد الضغط على زر سولوسمارت وإفلاته، يكون سولوسمارت في وضع الاستعداد ويجب وضعه في الوضع النشط قبل إجراء الحقن.

اتبع الخطوة ٤ في قسم «كيفية إعداد سولوسمارت» أعلاه لوضع الجهاز في الوضع النشط. بمجرد أن يصبح سولوسمارت في الوضع النشط، يصبح جاهزًا للاستخدام للحقن.


عند الحقن بواسطة سولوسمارت، يجب عليك القيام بما يلي

أحقن جرعتك دفعة واحدة، من الإصبع أو اليد أثناء الحقن.


اضغط بقوة وباستمرار على منتصف الزر، وليس من زاوية معينة.

أبق القلم ثابتًا ومستقيمًا أثناء الحقن.

بعد الحقن، استمر بالضغط بإبهامك على زر الحقن حتى ينطفئ الضوء الأخضر الذي يومض بسرعة.



استمر في الضغط حتى ينطفئ الضوء الأخضر الذي يومض بسرعة.



2 قم بتنزيل تطبيق متوافق وإقرانه مع سولوسمارت

قبل أن تتمكن من استخدام سولوسمارت، يجب عليك إقرانه بتطبيق الهاتف المحمول على هاتفك الذكي.

2.1 قم بتنزيل التطبيق من جوجل بلاي (أندرويد) أو متجر التطبيقات (آب ستور)® (آبل).



2.2 قم بإقران سولوسمارت باتباع الإرشادات الواردة في التطبيق لكي:
• تقوم بتشغيل البلوتوث الخاص بهاتفك الذكي (إذا لم يكن قيد التشغيل من قبل).
• تقوم بإقران سولوسمارت بالتطبيق.



ملاحظة: يجب أن تبقى سولوسمارت ضمن حدود ١٠ سنتيمترات من الهاتف الذكي أثناء الاقتران.






في نهاية خطوة الاقتران، قد تلاحظ أن ضوء الإشارة يتحوّل إلى اللون الأخضر ثم ينطفئ. بمجرد إقران سولوسمارت، سيدخل وضع الاستعداد وينطفئ الضوء.

2.3 بعد الاقتران، اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق لاختيار نوع الأنسولين.

3 توصيل سولوسمارت بقلم جديد

يتم توصيل سولوسمارت بزرّ الحقن بقلمك. اتبع الخطوات أدناه بعناية لتوصيله.

3.1 امسك سولوسمارت من خلال الغلاف الشفاف. يمكن رؤية الحواف المطاطية على السطح الخارجي لسولوسمارت.

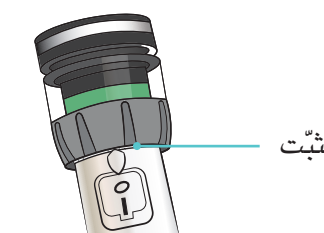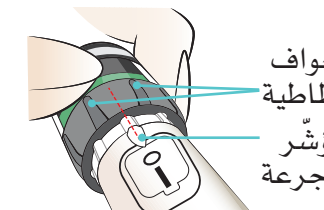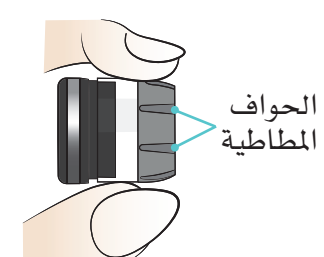

3.2 ضع سولوسمارت على القلم بحيث يكون مؤشر جرعة القلم بين الحواف المطاطية لسولوسمارت.

3.3 ادفع سولوسمارت على الغلاف الشفاف حتى تتم تغطية زر الحقن بالكامل.

استكشاف المشاكل وحلها

لم تتأكد مما إذا تم حقن الجرعة

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت حقنت الأنسولين، لا تكرر الحقن. راقب علاجك وسكر الدم لديك وفقًا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية الذي يتابعك.

استمر في الضغط حتى ينطفئ الضوء الأخضر الذي يومض بسرعة.

الضوء البرتقالي

شحنة البطارية منخفضة.

اشحن سولوسمارت باتباع الإرشادات الواردة في قسم «شحن سولوسمارت».


اشحن البطارية لمدة ساعتين على الأقل لشحنها بالكامل. لا تحقن بواسطة سولوسمارت أثناء الشحن.



الضوء الأحمر الثابت

خطأ: سيظهر الضوء الأحمر الثابت عندما يكون سولوسمارت في حالة خطأ ويحتاج إلى إعادة ضبط.

اتبع التعليمات الواردة في قسم «إعادة ضبط سولوسمارت» على الجانب الخلفي من هذه التعليمات لإعادة ضبط سولوسمارت.

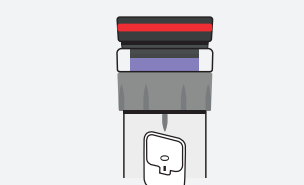

4 ضع سولوسمارت في الوضع النشط

لتفعيل سولوسمارت على القلم:

4.1 اضغط بقوة وواصل الضغط على زرّ سولوسمارت لمدة ٥ ثوان على الأقل حتى يصبح لون الضوء بنفسجيًا.

4.2 ثم ارفع إصبعك عن الزر. سيصبح لون الضوء بعد ذلك أخضر مظهرًا أن الجهاز في الوضع النشط الآن.

ملاحظة: إذا لم يتحوّل الضوء إلى اللون البنفسجي، تأكد من أن سولوسمارت مدفوع إلى الأسفل حتى النهاية. أصبح سولوسمارت الآن جاهزًا للاستعمال.

ملاحظة مهمة: اتبع التعليمات الواردة في قسم «حقن جرعة وسولوسمارت معلق بقلمك» أدناه عند إعطاء حقنة.

شحن سولوسمارت

تدوم بطارية سولوسمارت لمدة أسبوع واحد على الأقل بعد شحنها بالكامل في ظل الظروف العادية. عندما تكون شحنة البطارية منخفضة، سيظهر الضوء البرتقالي.





إشحن سولوسمارت عن طريق توصيله بالشاحن الجداري يو إس بي الذي يعمل بالطاقة (غير مزود) باستخدام سلك اليو إس بي المزود.

سيومض ضوء الإشارة باللون الأخضر ببطء عند شحن سولوسمارت. لا تحقن سولوسمارت أثناء الشحن.





اترك الجهاز يُشحن حتى ينطفئ الضوء الأخضر الوامض. (ساعتان لشحن كامل). سينطفئ الضوء عند الشحن الكامل.

إشحن لمدة ساعتين على الأقل لشحن كامل





كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل







كامل





كامل



كامل




كامل



1 ضع سولوسمارت في وضع الاستعداد

قبل نقل سولوسمارت إلى قلم آخر، يجب عليك أولاً وضعه في وضع الاستعداد حتى لا يتسبب نقل الجهاز في تسجيل جرعات خاطئة في التطبيق.

- 1.1 اضغط بقوة واستمر بالضغط على زر سولوسمارت لمدة 5 ثوانٍ على الأقل حتى يتحول الضوء الأخضر إلى اللون البنفسجي ثم ينطفئ.

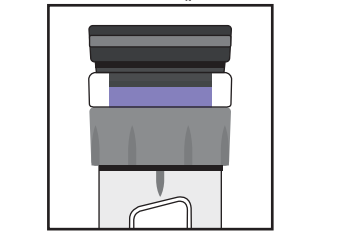

استمر بالضغط حتى ينطفئ الضوء

2 إنزع سولوسمارت من القلم




- 2.1 أمسك سولوسمارت من البدن بحيث تلمس أصابعك جوانب الجهاز فحسب، مع الحرص على عدم الضغط على الزر.
- 2.2 اسحب سولوسمارت من القلم مباشرة.
- 2.3 ضع سولوسمارت بشكل مستقيم على سطح مستو نظيف مع الضغط والزر نحو الأعلى.



3 توصيل سولوسمارت بقلم جديد

الرجاء اتباع الإرشادات الواردة في القسم «3 قم بتوصيل سولوسمارت بقلمك»

- 3.1 أمسك سولوسمارت الحواف المطاطية الشفافة.
- 3.2 ضع سولوسمارت على القلم بحيث يكون مؤشر الجرعة بين الحواف المطاطية لسولوسمارت.
- 3.3 ادفع سولوسمارت على الغلاف الشفاف حتى تتم تغطية زر الحقن بالكامل.



4 ضع سولوسمارت في الوضع النشط

لتفعيل سولوسمارت على القلم:

- 4.1 اضغط بقوة وواصل الضغط على زرّ سولوسمارت لمدة 5 ثوانٍ على الأقل حتى يصبح لون سولوسمارت بنفسيًا.
- 4.2 ثم ارفع إصبعك عن الزر. سيصبح لون ذلك أخضر مظهرًا أنّ الجهاز في الوضع النشط الآن.



إعادة ضبط سولوسمارت


1 إنزع سولوسمارت من القلم

إذا حدث ما يلي، فقد يكون من الضروري إعادة ضبط سولوسمارت:

- 1.1 أمسك سولوسمارت من البدن بحيث تلمس أصابعك جوانب الجهاز فحسب، مع الحرص على عدم الضغط على الزرّ.
- 1.2 اسحب سولوسمارت من القلم مباشرة.
- 1.3 ضع سولوسمارت بشكل مستقيم على سطح مستو نظيف مع الضغط والزر نحو الأعلى.


تحتج إلى إلغاء إقران سولوسمارت من هاتفك وإقرانه بهاتف جديد.

تريد حذف بياناتك الصحيّة الشخصية من الجهاز.



2 أعد ضبط سولوسمارت

- 2.1 قم بتوصيل سولوسمارت بسلك البو إس بي المزود.
- 2.2 قم بتوصيل سلك البو إس بي بشاحن جداري يعمل بالطاقة، ثم افصله بسرعة من الشاحن.
- 2.3 كرّر عمليّة التوصيل / الفصل ثلاث مرّات على الأقلّ حتّى يومض سولوسمارت باللون الأحمر وينطفئ.

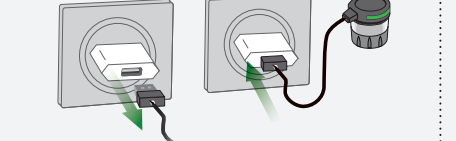


قم بالتوصيل والفصل ٣ مرّات على الأقل.


- 2.4 أفضل سولوسمارت من سلك البو إس بي.

3 دعه يرتاح لثلاثين ثانية

- 3.1 دع سولوسمارت يرتاح على سطح مستو والزرّ موجه إلى الأعلى لفاية 30 ثانية.




تمت إعادة ضبط سولوسمارت الآن.



4 ما هو التالي

بعد إعادة الضبط، يتم إيقاف تشغيل سولوسمارت ويجب إعداده مرة أخرى باتباع الإرشادات الواردة في قسم «كيفية إعداد سولوسمارت» في الصفحة الأولى من هذه التعليمات، بدءًا بالخطوة 1.



ملاحظة مهمة: يجب عليك إكمال جميع الخطوات في قسم «كيفية إعداد سولوسمارت».

أضواء الإشارة ومعانيها

أخضر ثابت

● أثناء الإعداد، يشير الضوء الأخضر الثابت إلى أن سولوسمارت قد تم تثبيته وإقرانه بشكل صحيح.

● أثناء الحقن، سيضيء ضوء أخضر ثابت أثناء قيامك بحقن الدواء.

أخضر سريع وامض

● أثناء الحقن، سيضيء ضوء أخضر وامض سريع عندما يستشعر سولوسمارت نهاية حقنة. أبق إصبعك على الزرّ حتى يتوقف الضوء عن الوميض لضمان حقن الجرعة الكاملة.

أخضر وامض بطيء

● سولوسمارت قيد الشحن. سينطفئ الضوء الأخضر الواضح البطيء عند شحن البطارية بالكامل. اشحن البطارية لمدة ساعتين على الأقل لشحنها بالكامل. لا تحقن بواسطة سولوسمارت أثناء الشحن.

أزرق

● أثناء الإعداد وعند الشحن، سوف يضيء ضوء أزرق عندما يكون سولوسمارت جاهزا للإقران أو غير مقترن. أثناء الحقن، إذا اشتعل ضوء أزرق، لا يكون سولوسمارت مقترنا بهاتفك ولا يسجل معلومات الحقن.

بنفسجي

● عند نقل سولوسمارت من قلم إلى آخر، سوف يضيء ضوء بنفسي ثم ينطفئ بعد فك سولوسمارت من القلم ووضعه على سطح مستو. بعد تركيب سولوسمارت على قلم آخر، سوف يضيء ضوء بنفسي قبل أن يتحول إلى اللون الأخضر لإظهار أنّ وضع النقل متوقف وأنّ سولوسمارت في الوضع النشط.

برتقالي

● شحنة البطارية منخفضة. سوف يضيء الضوء البرتقالي إذا كانت شحنة البطارية منخفضة. اشحن سولوسمارت باتباع الإرشادات الواردة في قسم «شحن سولوسمارت».

أحمر ثابت

● خطأ: سيظهر الضوء الأحمر الثابت عندما يكون سولوسمارت في حالة خطأ ويحتاج إلى إعادة ضبط.

● اتبع التعليمات الموجودة في قسم «إعادة ضبط سولوسمارت» لإعادة ضبط سولوسمارت.

لا ضوء

● ينطفئ الضوء تلقائيًا بعد 30 ثانية من عدم النشاط. للتحقق من حالة سولوسمارت، اضغط برفق على الزر لتثبيته. إذا لم يتم تشغيل الضوء، اضغط بقوة على الزرّ لعدة ثوانٍ لإخراجه من وضع الاستعداد ووضعه في الوضع النشط (راجع الخطوة 4 من قسم «كيفية إعداد سولوسمارت»).

● إذا لم يشتعل الضوء على الرغم من الضغط لفترة طويلة وثابتة، قد تكون البطارية فارغة. اشحن سولوسمارت باتباع الإرشادات الواردة في قسم «شحن سولوسمارت». اشحن البطارية لمدة ساعتين لشحنها بالكامل. سينطفئ الضوء الأخضر الواضح ببطء عند الشحن.

معلومات السلامة التقنيّة

في حالة حصول أعراض جانبية أو حوادث، يُرجى الاتصال بالشركة المصنّعة وبالسلمة الصحيّة المختصة.

قد يؤدي التشغيل غير السليم إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت قد حققت دواءك، لا تبدأ الحقن أو تكرره. راقب علاجه وفقًا لتعليمات مقدم الرعاية الصحيّة الذي يتابعك. احتفظ بالجهاز وسلك البو إس بي بعيدًا عن المستخدمين الآخرين أو المريض عند عدم استخدامه. لا تترك سولوسمارت ولا وزنه في متناول الأطفال (خطر الإصابة والاختناق). لا تقم بتوصيل السلك أو شدة بالراس أو الرقبة أو حولهما. لا تعرّض الجهاز لدرجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) أو أعلى للشمس. إذا تم استخدام سولوسمارت في درجات حرارة عالية تتجاوز توصياتنا، فقد يصل سطح الجهاز إلى درجة حرارة قصوي تبلغ 43 درجة مئوية. في هذه الحالة، يجب أن تقتصر مدة الاستخدام على 10 دقائق لتجنب أي خطر احتراق.

يحتوي سولوسمارت على مفاتيح، لضمان أفضل النتائج، تجنب ملامسة الأجزاء المعدنية أثناء الاستعمال، وتجنب استعمال سولوسمارت بالقرب من أجهزة تنظيم ضربات القلب ومزيلات الرخام ومضخات التسريب التي تثبت في الجسم أو محيط التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي). لا تشغّل الجهاز في بيئة خطيرة؛ حيث يمثل خطر حدوث انفجار، أو وجود منبثبات متطايرة (كحول، إيثانول، غازات قابلة للاشتعال) مواد تخدير، بيئة غنيّة بالأكسجين. (إيثانول). لا يمكن استعمال سولوسمارت إلا من قبل المرضى الذين لديهم دراية بإقلام الحقن. اتصل بمقدم الرعاية الصحيّة الذي يتابعك، أو الوكيل المعتمد لشركة «بايوكورب بروداكشن» BIOCORP PRODUCTION للتحقق من توافق قلمك والمتاد.

قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى حدوث إصابات جسدية أو أضرار فيمتلكات. لا تعرّض الجهاز للرطوبة. لا تغمر الجهاز في السوائل.

بكلمة مرور على هاتفك الذكي. - اتصل بشركة «بايوكورب بروداكشن»، BIOCORP PRODUCTION للحصول على قائمة بالتطبيقات المتوافقة المعتمدة لاستعمالها مع سولوسمارت. - يجب استخدام معدّات الترددات اللاسلكية المحمولة (بما في ذلك الأجهزة الطرفية مثل كابلات الهوائي والهوائيات الخارجية) على مسافة لا تزيد عن 12 بوصة (30 سنتيم) من أي جزء من جهاز سولوسمارت، بما في ذلك الكابلات الحادة التي قبل الشركة المصنّعة. قد يؤدي هذا إلى تدهور أداء هذه المعدّات. - في حالة حدوث اضطراب أو فقدان في إرسال البلوتوث، سيسمّر جهاز سولوسمارت في تنبّع تاريخ جميع حقنك وتسجيلها. يتوافر مزيد من المعلومات في المذكرة التقنيّة المتاحة على الإنترنت على <http://www.solosmart.com>. - لا تقم أبداً بتثبيت تطبيق جوال من متجر غير رسمية على هاتفك. - قم بحماية هاتفك الذكي عن طريق تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات. - مسميات الأمن السيبراني المطابقة لإصدار البرمجيات المدجة متاحة عند الطلب. يرجى الاتصال بالوكيل المعتمد لشركة «بايوكورب بروداكشن» BIOCORP PRODUCTION إذا كنت ترغب في مراجعتها. - أنت مسؤول عن تأمين هاتفك وإدارته بشكل صحيح. إذا كنت تشك في وقوع حدث سلب للأمن السيبراني يتعلق بجهاز سولوسمارت أو بالتطبيق ذي الصلة، اتصل بقسم خدمة الزبائن. - احرص على أن يكون هاتفك وجهاز سولوسمارت محفوظين في مكان آمن، وتحت سيطرتك، هذا مهم للمساعدة في منع أي شخص من الوصول إلى النظام أو العبث به. - التطبيق المستخدم مع جهاز سولوسمارت غير مخصص للاستخدام على هاتف تم تعديله أو تخصيصه لإزالة التكوين المعتمد من الشركة المصنّعة أو استبداله أو التجايل عليه أو تقييد الاستخدام، أو ينتهك بطريقة أخرى كفاءة الشركة المصنّعة. - في حالات نادرة، قد تحصل على قراءات غير دقيقة لجرعة

الأنسولين. إذا كنت تعتقد أن قراءاتك غير صحيحة أو غير متوافقة مع ما تشعر به، قم بإجراء فحص لجلوكون الدم بأصبعك لتأكيد مستوى جلوكون لديك. إذا استمرت المشكلة، اتصل بقسم خدمة الزبائن. - يتطلب التطبيق المستخدم مع جهاز سولوسمارت أن يكون هاتفك التاريخ والوقت الصحيحان لتسجيل معلوماتك الصحيّة. يجب ضبط تاريخ ووقت هاتفك للتثبيت تلقائيًا. يمكنك التحقق من ذلك في إعدادات هاتفك. - عند استخدام التطبيق المتصل مع جهاز سولوسمارت، يجب أن تبقى هاتفك مشحونًا بشكل جيّد وأن تتأكد من أنه يمكنك الوصول إلى نظام مراقبة جلوكون الدم. - أبق هاتفك مشحونًا بشكل جيّد ومشغلاً. - قم بتعطيل تحديثات نظام التشغيل التلقائيّ بهاتفك. بعد تحديث نظام التشغيل، افتح تطبيقك وتحقق من إعدادات جهازك للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. - قبل التخلّص من سولوسمارت: أعد ضبط الجهاز لحذف جميع بياناتك الصحيّة الشخصية. - يُخضع الأجهزة والأنظمة الطبيّة الكهربيّة لتدابير خاصة تتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي ويجب تركيبها وفقًا لتعليمات التوافق الكهرومغناطيسي الواردة في المذكرة التقنيّة المتاحة على الإنترنت على <http://www.solosmart.com>. - يجب تجنّب استخدام هذا الجهاز بالقرب من أو مكسدًا مع معدّات أخرى لأن ذلك قد يؤدي إلى تشغيل غير سليم. إذا كان هذا الاستخدام ضروريًا، فيجب مراقبة هذا الجهاز والمعدّات الأخرى للتحقق من أنها تعمل بشكل طبيعي.

قد يؤدي استخدام الوازوم والحلّولات والكابلات غير تلك المحددة أو المزوّدة من قبل الشركة المصنّعة لهذا الجهاز إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسيّة أو تقليل المناعة الكهرومغناطيسيّة لهذا الجهاز مما يؤدي إلى التشغيل غير السليم. - ملاحظة: في حالة استخدام التطبيق الأصلي والجهاز في بيئة صاخبة (من حيث الإشارة الكهرومغناطيسيّة التي تقارب 2.4 جينغا هرتز)، لا يعود اتصال بلوتوث منخفض الطاقة ممكنًا وينقطع الاتصال بينهما. ومع ذلك، يستمرّ الجهاز في تتبّع الحقن. في حالة اختفاء الإشارات الكهرومغناطيسيّة الضخمة، يمكن للتطبيق الأصلي والجهاز الاتصال مرة أخرى.

الوصف	الرمز
المستخدمون المستهدفون	المرضى المعتمدون على الأنسولين الذين يستخدمون قلم الحقن لعلاج الأنسولين
المستخدمون المستهدفون	المستخدمون الذين تراوح أعمارهم من 14 إلى 80 عامًا
بيئة الاستخدام	الاستخدام المنزلي أو في مرافق طبيّة (في الداخل فقط)
دقة الجرعات المسجلة	± 99% وحدة دويّة على مقعد الاختبار
الشحن والاستقلاليّة	الشحن عن طريق وصلة بو إس بي. شحن كامل بساعتين واستقلاليّة لأسبوع واحد. محمول التيار للتردد يو إس بي (غير مزوّن). IEC / UL 60950-1 أو IEC / UL 62368-1 معتمد بعلامة CE وUL وحدة خارجية مع تكليف تلقائيّ للتحقق، نطاق جهد المدخلات 90-264 فولت.
التعرف الكهربيّ المطابقة	5 فولت تيار مباشر، 500 مللي أمبير كمث أدنى لتييوم أيون 3.6 فولت 25 مللي أمبير في الساعة
الاتصال	بلوتوث منخفض الطاقة V4.2 يعمل في نطاق تردّد من 2400 ميغا هرتز، عرض نطاق قناة 1 ميغا هرتز، أقصى قوة نقل 4 دي بي ام 19.8 (ميجوات). أقصى قدرة شدّة مكافئة مسوح بها 6.18 ديسيبل ملي وات.
إصدار البرنامج	البرامج الثابتة x5.3
الأبعاد	23.3 مم (ارتفاع) × 21.4 × 8 مللم
الوزن	20 غم
شروط التخزين والنقل	جهاز حساس للرطوبة
ظروف التشغيل	حدود درجة الحرارة التي يمكن أن يتمرّن لها الجهاز بأمان.
إمكانيّة مسرّعة الترميم	حدود الضغط التي يمكن أن يتمرّن لها الجهاز بأمان.
تتضمن المذكرة التقنيّة معلومات تقنيّة إضافية، وهي متوافرة عبر الإنترنت على www.solosmart.com و my-mallya.com	

BIOCORP PRODUCTION
ZI DE LAVAUR - LA BECHADE
63500 ISSOIRE - FRANCE
Tel : +33 4 73 55 70 50
www.biocorpsys.com

خدمة العملاء في المملكة العربية السعودية
(عملاء المملكة العربية السعودية فقط)
الهاتف: 00966114742340
الرقم المجاني: 8001240226
أو واتس-اب: 00966554673579
للاستخدام الداخلي فقط

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في استعمال سولوسمارت (SoloSmartTM) أو لإبلاغ عن الشكاوى الفنية المتعلقة بالمنتج، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء سولوسمارت (SoloSmartTM):
الهاتف: 00966114742340
الرقم المجاني: 8001240226
أو واتس-اب: 00966554673579
للاستخدام الداخلي فقط

إذ كنت بحاجة إلى مساعدة في استعمال سولوسمارت (SoloSmartTM) أو لإبلاغ عن الشكاوى الفنية المتعلقة بالمنتج، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء سولوسمارت (SoloSmartTM):
الهاتف: 00966114742340
الرقم المجاني: 8001240226
أو واتس-اب: 00966554673579
للاستخدام الداخلي فقط

بمجرد الحصول على معلومات طبيّة، يرجى الاتصال: 00966126693318
الهاتف: 00966126693318
البريد الإلكتروني: np.c.drug@sfd.a.gov.sa
<https://ade.sfd.a.gov.sa/>
للحصول على معلومات طبيّة، يرجى الاتصال: 00966126693318
الهاتف: 0020222860060 أو 0020222860000
الهاتف: 0020222860060 أو 0020222860000
البريد الإلكتروني: KSA.Medicalinformation@sanofi.com
خدمة العملاء جمهورية مصر العربيّة (عملاء جمهورية مصر العربيّة فقط)
الهاتف: 00966114742340
الرقم المجاني: 8001240226
أو واتس-اب: 00966554673579
للاستخدام الداخلي فقط

إذ كنت بحاجة إلى مساعدة في استعمال سولوسمارت (SoloSmartTM) أو لإبلاغ عن الشكاوى الفنية المتعلقة بالمنتج، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء سولوسمارت (SoloSmartTM):
الهاتف: 00966114742340
الرقم المجاني: 8001240226
أو واتس-اب: 00966554673579
للاستخدام الداخلي فقط

بمجرد الحصول على معلومات طبيّة، يرجى الاتصال: 00966126693318
الهاتف: 00966126693318
البريد الإلكتروني: KSA.Medicalinformation@sanofi.com
خدمة العملاء جمهورية مصر العربيّة (عملاء جمهورية مصر العربيّة فقط)
الهاتف: 00966114742340
الرقم المجاني: 8001240226
أو واتس-اب: 00966554673579
للاستخدام الداخلي فقط

إذ كنت بحاجة إلى مساعدة في استعمال سولوسمارت (SoloSmartTM) أو لإبلاغ عن الشكاوى الفنية المتعلقة بالمنتج، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء سولوسمارت (SoloSmartTM):
الهاتف: 00966114742340
الرقم المجاني: 8001240226
أو واتس-اب: 00966554673579
للاستخدام الداخلي فقط

بمجرد الحصول على معلومات طبيّة، يرجى الاتصال: 00966126693318
الهاتف: 00966126693318
البريد الإلكتروني: KSA.Medicalinformation@sanofi.com
خدمة العملاء جمهورية مصر العربيّة (عملاء جمهورية مصر العربيّة فقط)
الهاتف: 00966114742340
الرقم المجاني: 8001240226
أو واتس-اب: 00966554673579
للاستخدام الداخلي فقط

